

声 明

河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章

一、本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

二、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

三、


河南省政院检测研究院有限公司

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业用途的，本公司将依法追究其法律责任。





检测报告

0.01 mg/L	铅	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP7200	0.00 mg/L
	镉	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP7200	0.05 μg/L
0.01 mg/L	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP7200	
0.01 mg/L	锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP7200	

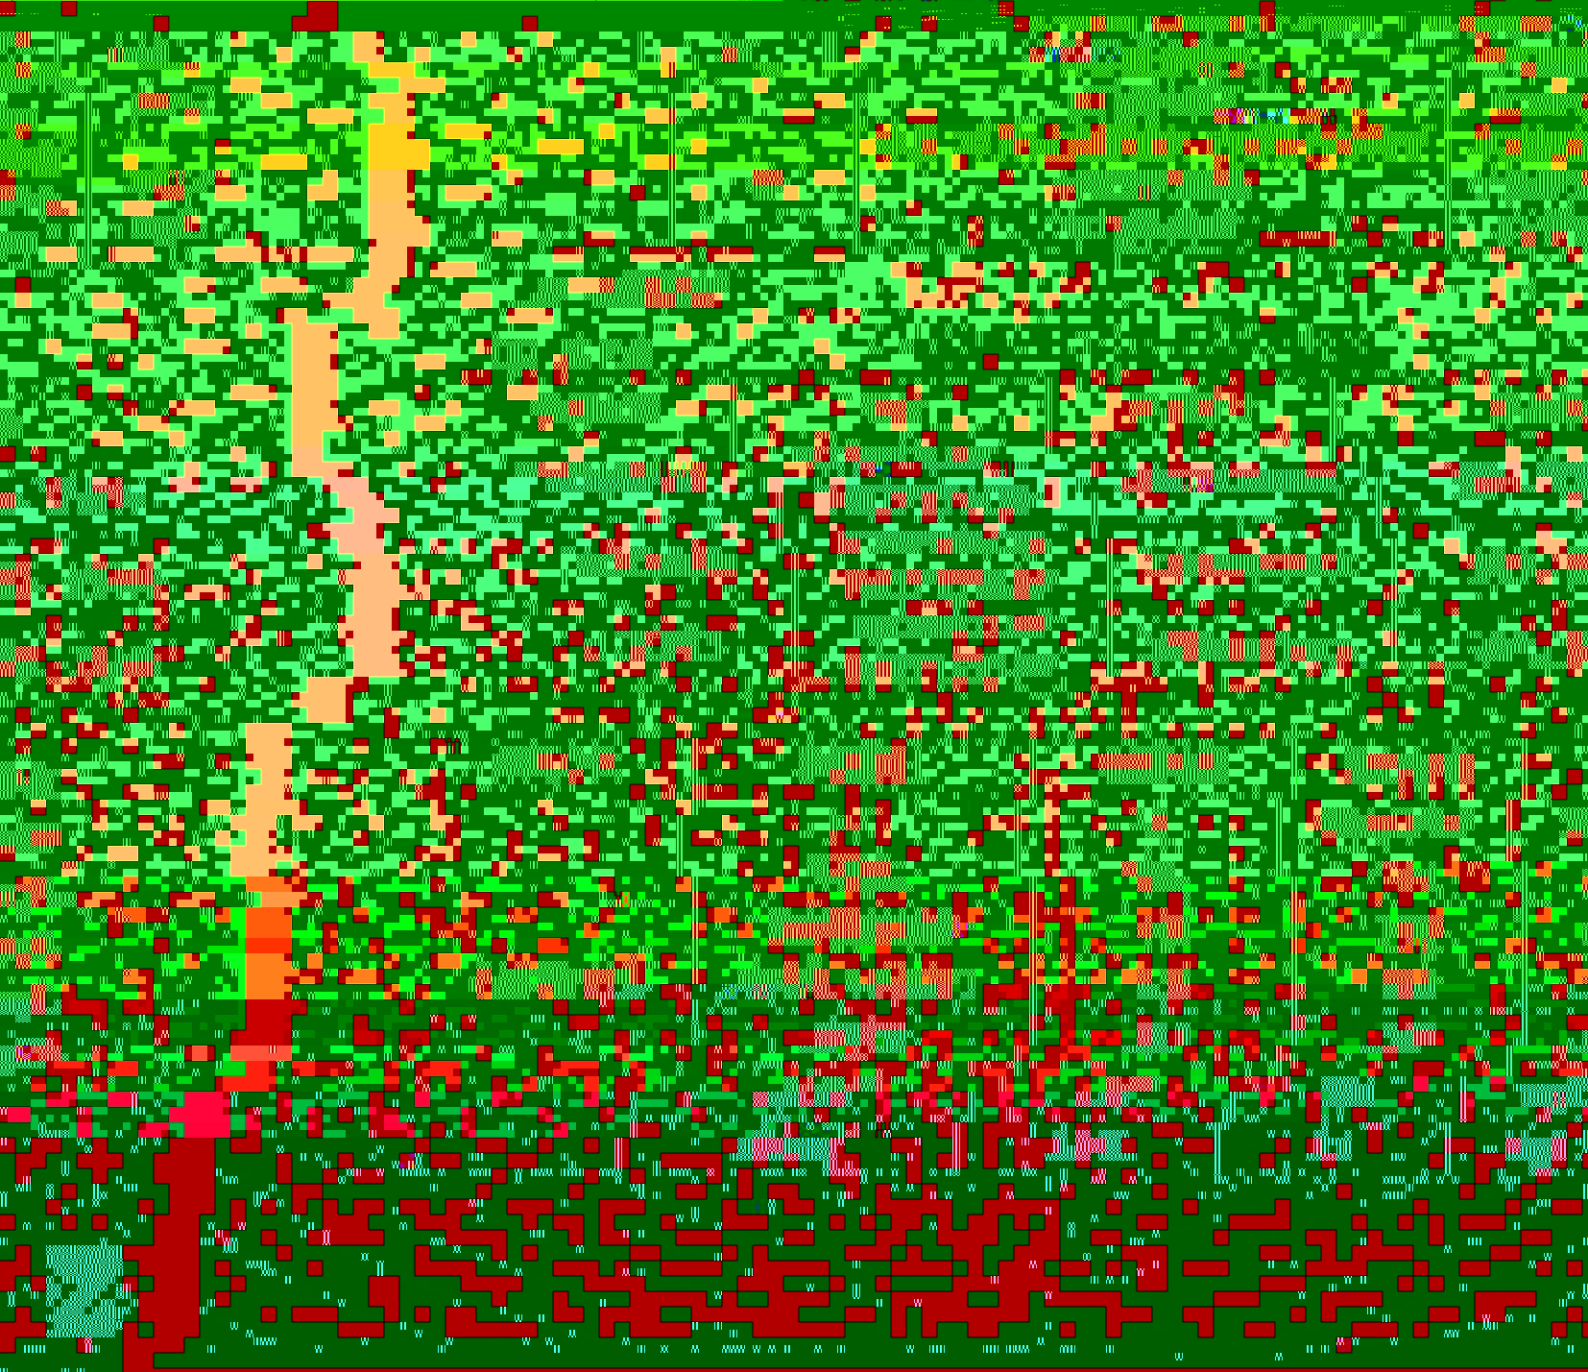

松 湖 研 究 生

—

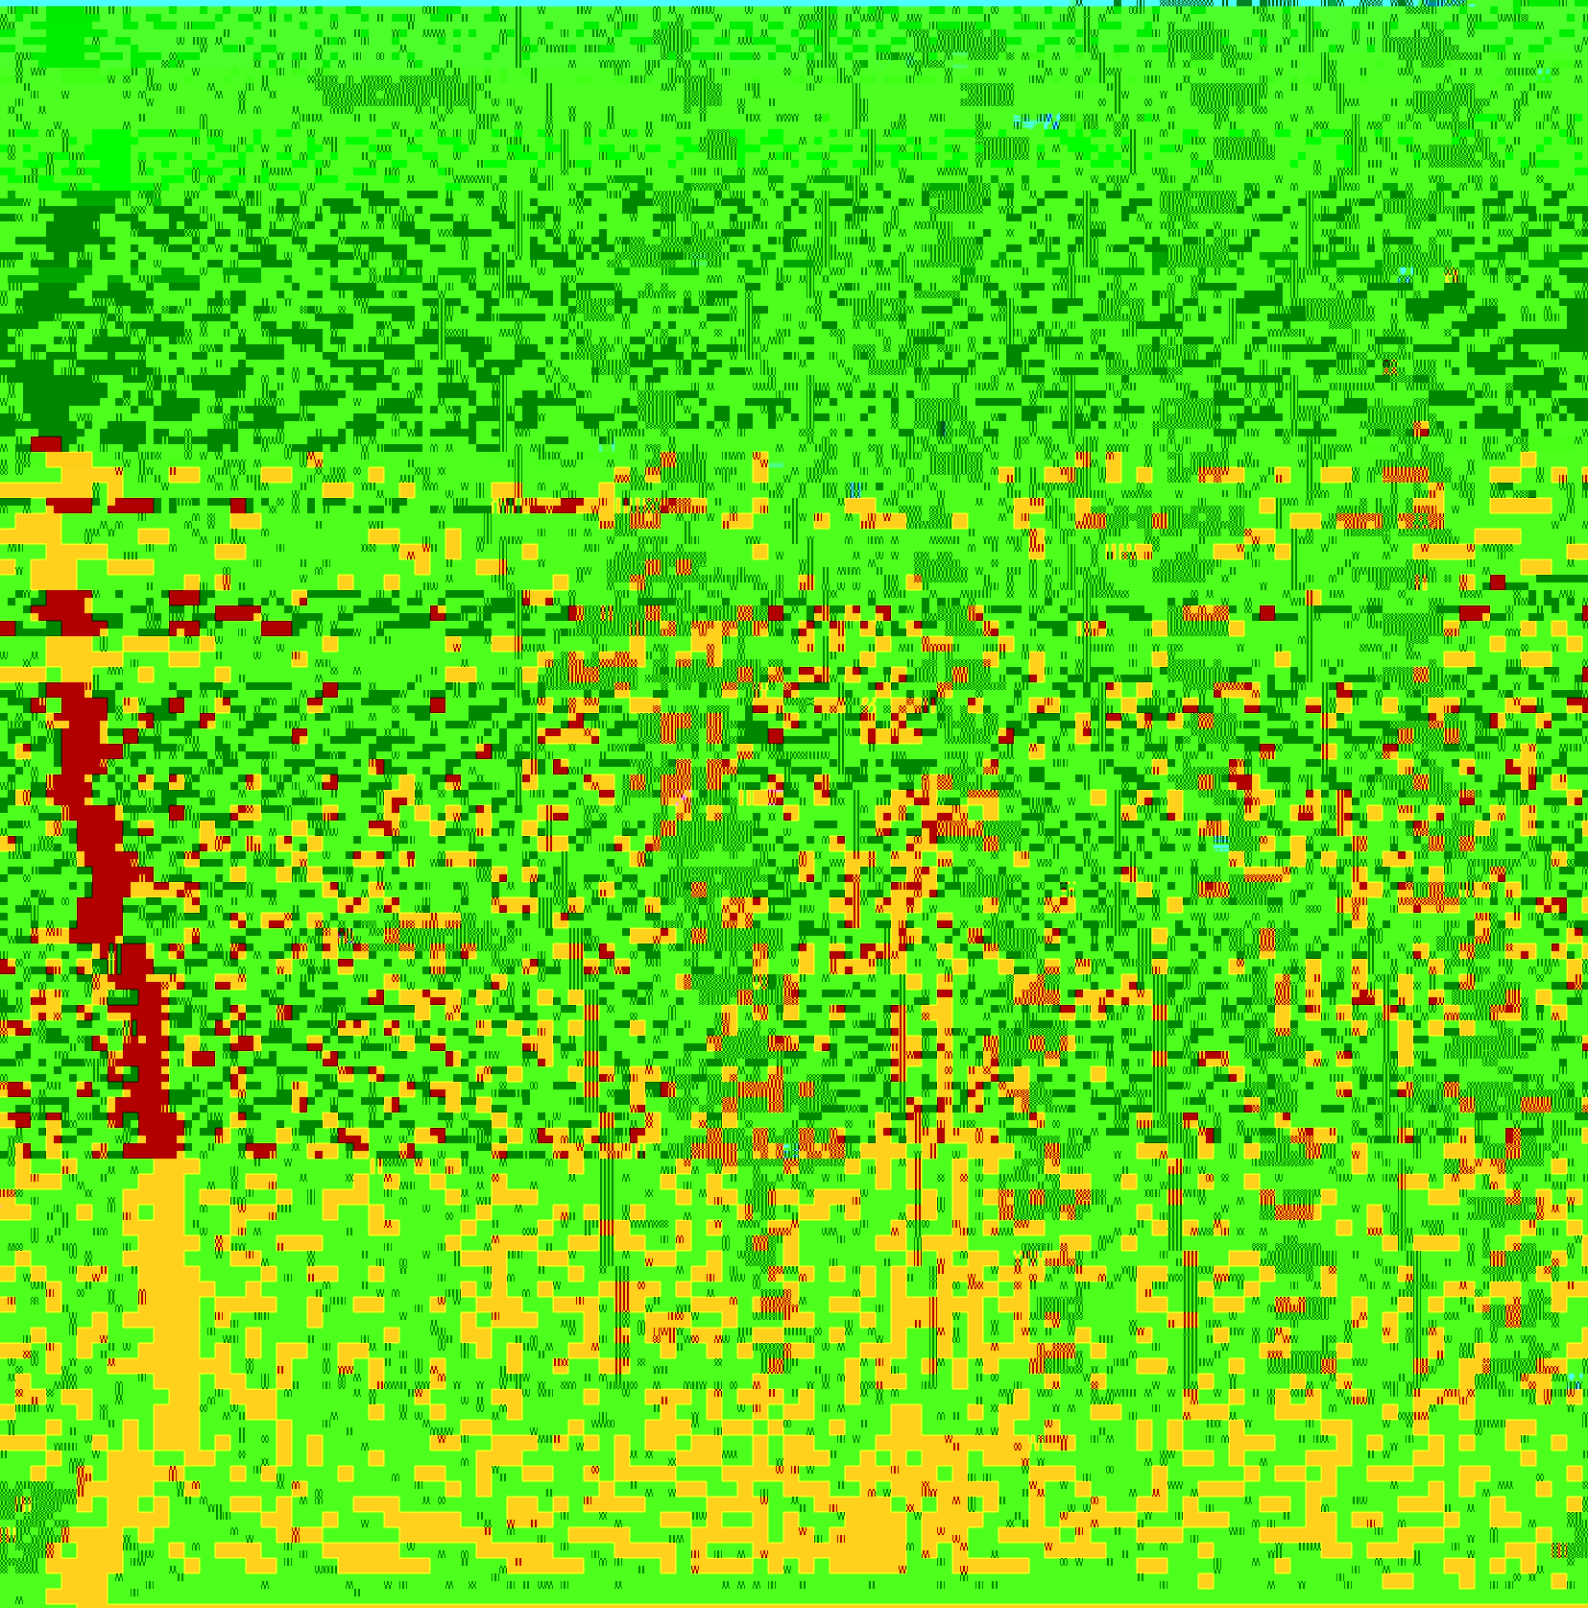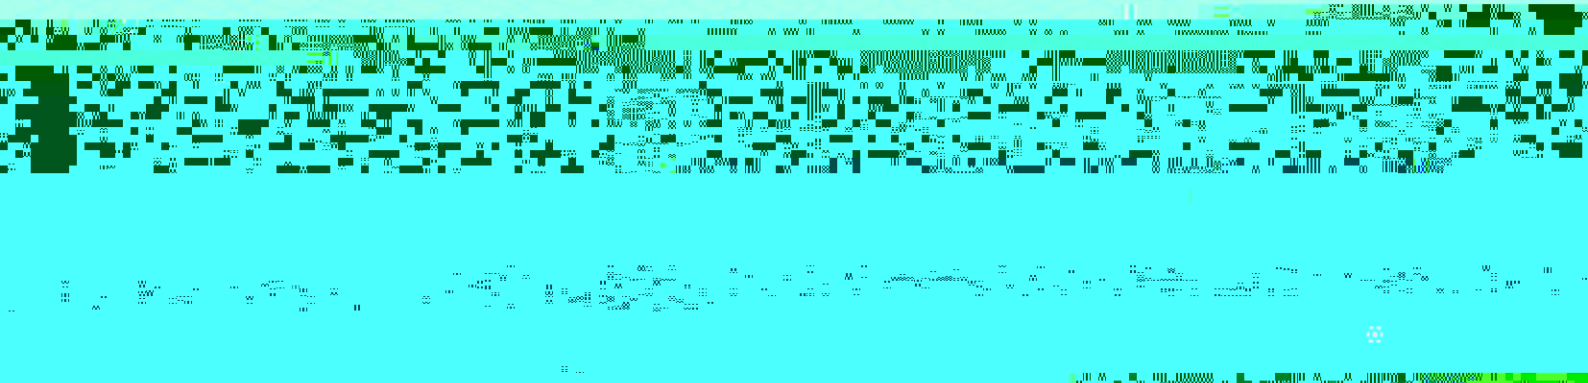

检测报告

续上表

氯化物	7575	7750	mg/L
硫酸盐	ND	0.01	mg/L
钼	ND		
镉	ND	0.10	mg/L
铜	ND	1.00	mg/L
锌	ND	1.00	mg/L

注: ND表示检测结束低于检出限, 检出限详见检测分析方法;

1. 执行标准为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) Ⅲ类限值, 表 2 中。

编制:

审核:

检测人姓名:

陈显伟

报告结果

